



เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและนำยาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของประเภทการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ

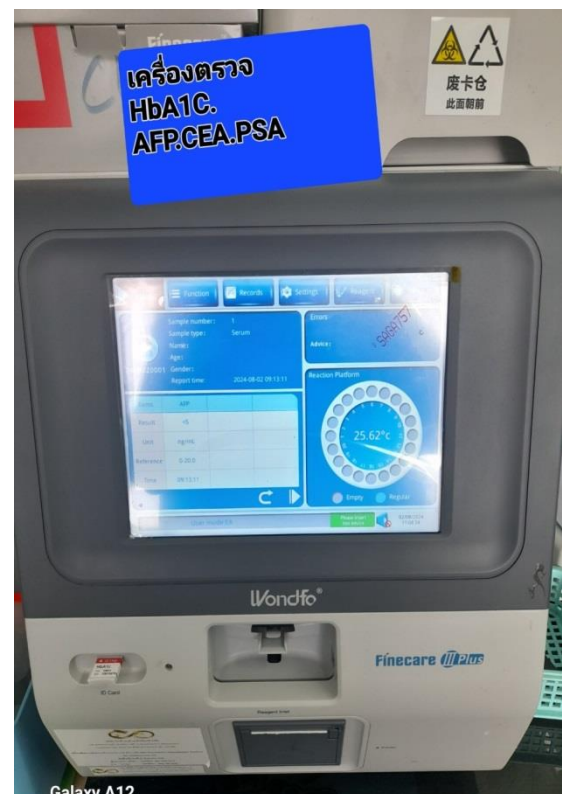

เครื่องตรวจThyroid

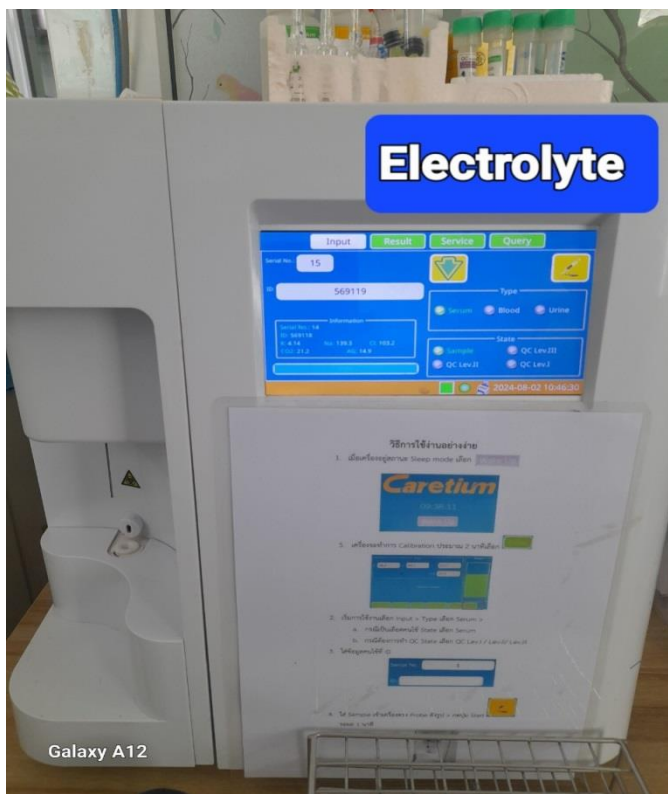


เครื่องตรวจ PT(INR) APTT



เครื่องปั่นHematocrite



เครื่องตรวจแถบปัสสาวะ

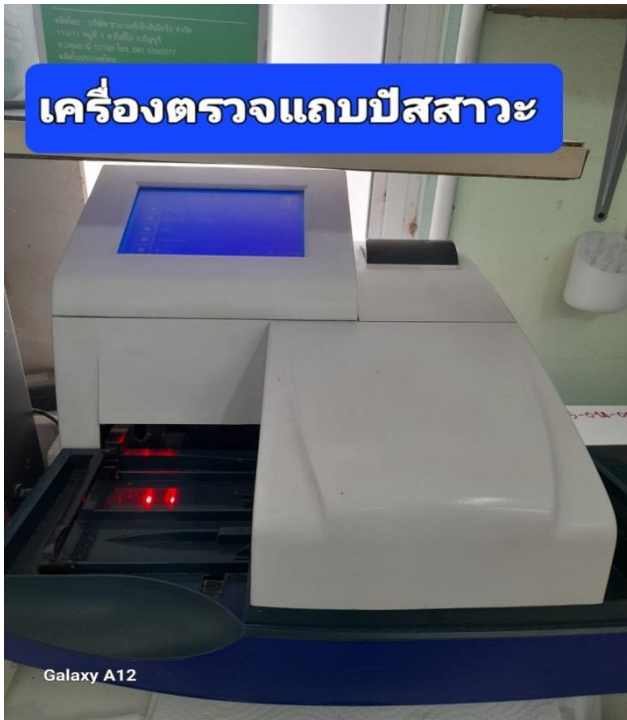

เครื่องย้อมSlide



กล้องจุลทรรศน์




เครื่องปั่นตกตะกอน

1

2

Galaxy A12

เครื่องตรวจ MB

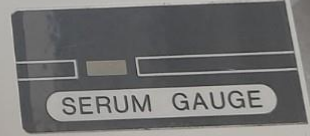

Before the start-up counter ends with "0"
- DO NOT insert a capillary into the holder.
- DO NOT remove the holder.

ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาสิ่งตัวอย่างและน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์

